TPLO · GUÍA RÁPIDA DE SELECCIÓN E INSTRUMENTAL

Selección de placa, tornillos, brocas y guías · BlueSAO

01 SELECCIÓN DE PLACA SEGÚN PESO

	MINI		S			M		L	
	< 3 kg	3–5 kg	4–8 kg	6–15 kg	13–18 kg	15–22 kg	20–28 kg	25–38 kg	> 35 kg
Sierra	8–10 mm	10–12 mm	12–15 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	24–27 mm	30–33 mm
Placa	4 mm-L	4 mm	5.5 mm	6.5 mm	7 mm	8.5 mm	9.5 mm	10.5 mm	11.5 mm
Broca Bloqueos	1.3 mm	1.3 mm	1.8 mm	1.8 mm	1.8 mm	2.5 mm	2.5 mm	3.0 mm 3.2 mm	3.0 mm 3.2 mm
Tornillos bloqueo	1.8 HL	1.8 HL	2.4 HC 2.4 BL	2.4 HC 2.4 BL	2.4 HC 2.4 BL	3.5 HC 3.2 BL	3.5 HC 3.2 BL	4.0 HC 4.0 BL	4.0 HC 4.0 BL

NOTA: Los rangos de peso y tamaños indicados son orientativos y no sustituyen el criterio clínico del cirujano. La selección final del implante y del instrumental debe basarse en la anatomía del paciente y las características específicas de cada caso.



GUÍA HC- Hueso Esponjoso

HC · TORNILLO PARA HUESO ESPONJOSO



GUÍA BLOQUEO

BL · TORNILLO DE BLOQUEO



No se enrosca a a placa.
Guía de posicionamiento en el orificio.

GUÍA CORTICAL (pre-locking)

CORTICAL · TORNILLO DE COMPRESIÓN

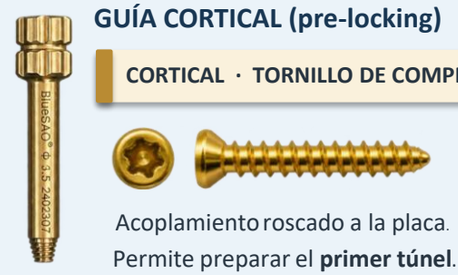

Acoplamiento roscado a la placa.
Permite preparar el **primer túnel**.

PRE-LOCKING · ORDEN RECOMENDADO

- Guía cortical: roscar a la placa y realizar la primera perforación.
- Guía Locking: utilizar el túnel previo como referencia para alinear la guía.
- Perforación: introducir la broca de bloqueo y realizar el segundo túnel.

Uso tornillos corticales compresión

- Talla S: broca de 1.1mm /Tornillos 1.5mm
- Talla M: Broca 1,8mm/ Tornillos 2.4mm.
- Talla L: Broca 2.0mm /Tornillos de 2.7 mm

MINI · Todos los orificios utilizan tornillos HL con guia 1.8 HL. Incluye una única guía HL de 1.3 mm.